


色度座標 (R, G, B, W) の一般校正

校正証明書に校正結果と不確かさを表記いたします。

■ 対象測定器

分光放射輝度計及び
色彩輝度計

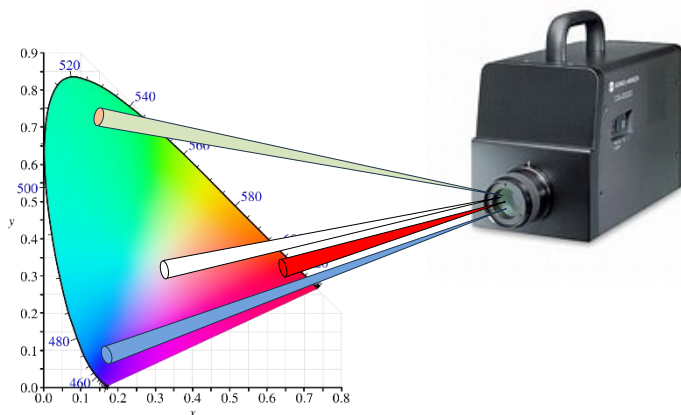

※ カラーアナライザは不可

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ (信頼の水準約95%)
R,G,B,W 相当の色度座標(x,y)	x : 0.005、y : 0.006

構造等によって、校正できない場合がありますので必ずお問い合わせください。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>